

INTUITIVE

Câmera Portátil da Vinci

Manual do Usuário do Sistema

Anexo



Intuitive Surgical, Inc.
1266 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086 USA
intuitive.com

EC REP

Intuitive Surgical SAS
11 avenue de Canteranne
33600 Pessac, France



PN 555467-03 Rev. A 2024.04
(Brazilian Portuguese)

Direitos autorais

© 2021–2024 Intuitive Surgical Operations, Inc. Todos os direitos reservados. Os nomes de produtos são marcas comerciais e marcas registradas dos respectivos proprietários.

Marcas registradas

Os nomes/logotipos de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas registradas da Intuitive Surgical, Inc. ou de seus respectivos proprietários. Consulte intuitive.com/trademarks.

Rx only

Descrição geral da Câmera Portátil da Vinci

Este anexo ao *Manual do Usuário do Sistema da Vinci Xi*, ao *Manual do Usuário do Sistema da Vinci X* e ao *Manual do Usuário do Sistema da Vinci SP* disponibiliza as seguintes informações sobre a Câmera Portátil da Vinci:

- Uso pretendido
- Avisos e precauções
- Funções e controles da Câmera Portátil da Vinci®
- Inspeção da Câmera Portátil da Vinci
- Inspeção do Guia de Luz da Câmera Portátil (guia de luz)
- Montagem da Câmera Portátil da Vinci
- Desconexão da Câmera Portátil da Vinci
- Armazenamento, transporte e embalagem
- Resolução de problemas
- Látex de borracha natural

Mantenha este anexo junto de sua documentação de usuário do sistema da Vinci Xi®, da Vinci X® e da Vinci SP®. Para informações completas sobre o uso do sistema de visualização, incluindo avisos e precauções gerais, consulte o respectivo manual do usuário do sistema.

Uso pretendido

A Câmera Portátil da Vinci destina-se à visualização endoscópica durante procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Ela é projetada para utilização com sistemas cirúrgicos da Vinci compatíveis. A câmera é indicada para uso adulto e pediátrico. Ela deve ser usada por médicos treinados, em ambiente de sala cirúrgica.

Avisos gerais

Para avisos e precauções gerais do sistema da Vinci, consulte *Câmera Portátil da Vinci – Anexo ao Manual do Usuário do Sistema*, o *Manual do Usuário do Sistema da Vinci Xi*, o *Manual do Usuário do Sistema da Vinci X* e o *Manual do Usuário do Sistema da Vinci SP*.

-  **AVISO:** Desligue o iluminador quando o laparoscópio ou o cabeçote da câmera for removido do guia de luz, para evitar quebra de esterilidade ou lesão térmica ao paciente ou usuário.
-  **AVISO:** Desligue a iluminação antes de mudar para um laparoscópio diferente, para evitar queimaduras ou incêndios que resultem em comprometimento da esterilidade.
-  **AVISO:** Não coloque laparoscópios e guias de luz no paciente ou em panos cirúrgicos do paciente, para evitar quebra de esterilidade ou lesão térmica ao usuário ou paciente.
-  **AVISO:** Use a saída de luz mínima necessária para obter a imagem desejada, para evitar queimaduras no usuário ou paciente.
-  **AVISO:** Use apenas laparoscópios com 5–10 mm de diâmetro, para evitar lesões térmicas.
-  **AVISO:** Realize uma inspeção, preparação e operação seguras de possíveis fontes de calor, para evitar danos térmicos ao paciente ou usuário.
-  **AVISO:** Evite a exposição direta dos olhos à luz emitida pelas aberturas de iluminação (por exemplo, conector do guia de luz e ponta do laparoscópio) para prevenir lesões oculares.
-  **AVISO:** Evite o contato direto ao manusear os componentes do dispositivo laparoscópico (por exemplo, eixo, ponta e interface do guia de luz) que podem estar quentes durante e depois do uso, para prevenir queimaduras no usuário ou no paciente.
-  **AVISO:** Não coloque instrumentos de energia monopolar em contato direto com o laparoscópio, para evitar lesões em tecidos, danos ao paciente ou choque elétrico.
-  **AVISO:** Use o sistema somente com cabeçotes de câmera, guias de luz e laparoscópios compatíveis, para evitar lesões oculares.
-  **AVISO:** Depois que o uso da Câmera Portátil da Vinci estiver concluído, desligue a iluminação, para evitar queimaduras ou incêndios que resultem em comprometimento da esterilidade.
-  **AVISO:** Evite o contato de componentes (por exemplo, ponta, eixo e cabo do guia de luz) com materiais inflamáveis quando a fonte de luz estiver ligada, para prevenir incêndios que resultem em comprometimento da esterilidade.
-  **AVISO:** Evite o contato de componentes (por exemplo, ponta, eixo e cabo do guia de luz) com materiais inflamáveis quando a fonte de luz estiver ligada, para prevenir queimaduras no usuário ou paciente.
-  **AVISO:** A fim de prevenir infecções, siga boas práticas de gestão de cabos ao passar o cabo da câmera. Não passe o cabo por locais onde possa ser comprimido, dobrado em excesso ou torcido.
-  **Nota:** A utilização de dispositivos laparoscópicos na presença de sistemas de ressonância magnética (RM), tomografia computorizada (TC), diatermia ou segurança eletromagnética não foi testada. Não use dispositivos laparoscópicos perto desses dispositivos.

-
- i** **Nota:** Não use a câmera, o guia de luz e laparoscópios com qualquer defeito ou sinal de dano, incluindo avarias nas portas de luz ou nas superfícies de fibra ótica.
 - i** **Nota:** Evite que a ponta do laparoscópio entre em contato com a anatomia do paciente.
 - i** **Nota:** Não dobre o eixo do endoscópio ao usar um laparoscópio de pequeno diâmetro com uma cânula de diâmetro maior.
 - i** **Nota:** Ajuste o nível de luminosidade antes de ajustar o nível do iluminador.
 - i** **Nota:** O guia de luz e o laparoscópio podem causar queimaduras devido à temperatura esperada da superfície ou ao nível de potência de iluminação do dispositivo.
 - i** **Nota:** Não use a Câmera Portátil da Vinci com iluminadores ou guias de luz de outros fabricantes com cabeçote de câmera.
- O Guia de Luz da Câmera Portátil, o Adaptador do Guia de Luz Portátil (adaptador) e o laparoscópio devem ser limpos e esterilizados antes de cada uso. Se uma capa de outro fabricante não estiver sendo usada, a Câmera Portátil da Vinci também deve ser limpa e esterilizada antes de cada uso. Consulte as *Instruções de Reprocessamento da Câmera Portátil da Vinci* para métodos e parâmetros de reprocessamento.
 - Use uma cânula de 8 mm (PN 470002) com um obturador ótico sem lâmina de 8 mm (PN 470359) ao utilizar laparoscópios de 5 mm de outros fabricantes. Consulte o manual do usuário de instrumentos e acessórios que se aplique para mais informações sobre as combinações apropriadas entre laparoscópios de terceiros com cânulas, obturadores, redutores e portas nos Kits de Porta de Acesso do SP.


Funções e controles da Câmera Portátil da Vinci

Câmera Portátil da Vinci

A Câmera Portátil da Vinci (PN 470035) é uma câmera 2D utilizada com laparoscópios de 5-10 mm fabricados por terceiros. Ela permite a visualização do campo cirúrgico em procedimentos minimamente invasivos assistidos por robô.

A Câmera Portátil da Vinci é constituída pelos seguintes componentes:

Figura 1 Componentes da Câmera Portátil da Vinci

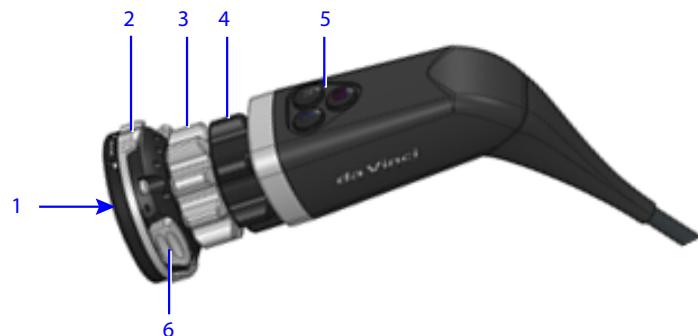

1. Interface do laparoscópio (com retensores da lente ocular)
2. Anel de travamento da lente ocular do laparoscópio
3. Foco
4. Zoom
5. Botões Ligar/Desligar Iluminador, Balanço de Branco e Tirar Foto
6. Alavanca de liberação da lente ocular (uma de cada lado)

Figura 2 Alavancas de liberação não pressionadas – cliques retentores encaixados



1. Cliques de retenção da lente ocular


Figura 3 Alavancas de liberação pressionadas – cliques retentores retraídos



Guia de luz e adaptador

O Guia de Luz da Câmera Portátil (PN 470042) fornece luz a laparoscópios de outros fabricantes por meio do Controlador do Endoscópio. O Adaptador do Guia de Luz da Câmera Portátil (PN 470051) conecta o guia de luz à maioria dos laparoscópios disponíveis no mercado. Alguns laparoscópios podem exigir um adaptador diferente.


Figura 4 Componentes do guia de luz

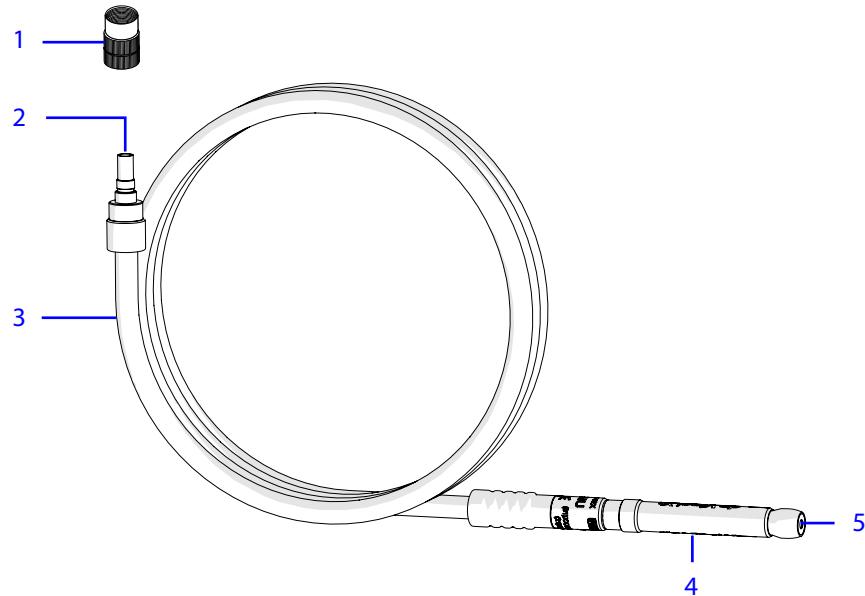

1. Adaptador removível do guia de luz (o guia de luz conecta-se a laparoscópios de outros fabricantes)
2. Superfície de fibra óptica
3. Cabo de fibra
4. Conecta-se ao cabo da câmera (interface do Controlador do Endoscópio)
5. Superfície de fibra óptica (atrás de um visor)

O cabo da câmera transmite sinais de vídeo e comunicação entre a Câmera Portátil da Vinci e o Controlador do Endoscópio. O guia de luz transmite a luz do Controlador do Endoscópio para a Câmera Portátil da Vinci. O guia de luz conecta-se ao seu respectivo conector no cabo da câmera. Os cabos unidos são então conectados ao Controlador do Endoscópio. O cabo da câmera não deve ser ligado ao Controlador do Endoscópio sem que o guia de luz esteja conectado a ele.

Figura 5 Componentes da Câmera Portátil

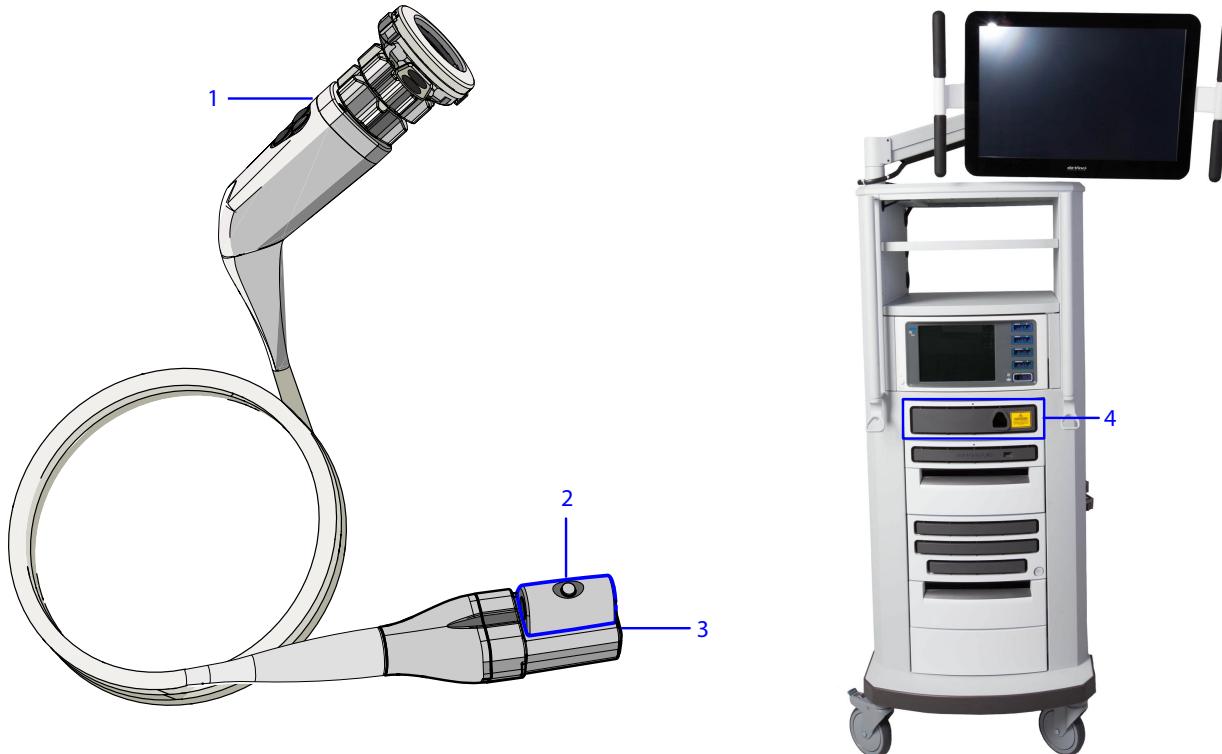

1. Câmera Portátil da Vinci
2. Conector do guia de luz e botão de liberação
3. Conector do Controlador do Endoscópio
4. Controlador do Endoscópio

Compatibilidade com laparoscópios

Qualquer laparoscópio rígido de 5-10 mm fabricado por terceiros que tenha uma tampa de lente ocular compatível com a norma ISO/TS 18339 pode ser conectado à Câmera Portátil da Vinci.

Botões da câmera

Os botões da câmera têm funções de pressão breve e pressão longa. A tabela a seguir lista essas funções.

Botão	Pressão breve	Pressão longa
Ligar/Desligar Iluminador e Luminosidade	Alternar entre sete níveis de luminosidade, desde a mais baixa até a mais alta. O nível de luminosidade padrão é de 50%.	Ligar/Desligar Iluminador
Balanço de branco	Não utilizado	Realiza o balanço de branco
Tirar foto	Tirar foto	Tirar foto

- Iluminador/Luminosidade: este botão tem duas funções, uma de pressão breve e outra de pressão longa. A pressão longa liga ou desliga o iluminador. A pressão breve alterna entre sete níveis de luminosidade, da mais baixa até a mais alta. Quando o nível mais alto for selecionado, a próxima pressão breve fará a luminosidade retornar ao menor nível.
- Balanço de branco: ao pressionar longamente o botão, é realizado um balanço de branco manual da Câmera Portátil da Vinci.
- Tirar foto: captura uma imagem a partir da visão laparoscópica. O sistema salva a imagem em uma unidade USB conectada ao processador de vídeo no Carrinho de Visão. Se uma unidade USB não for conectada ao processador de vídeo, o botão Tirar Foto será desabilitado. Se o botão Tirar Foto na câmera for pressionado, o botão Tirar Foto na tela sensível ao toque piscará e retornará ao estado desativado.


Tela de toque do Carrinho de Visão



AVISO: Garanta o uso seguro e eficaz do sistema de visão, incluindo a interação direta com o iluminador, para evitar lesões por queimadura, lesões por radiação infravermelha ao usuário ou ambas.

Quando a Câmera Portátil da Vinci é ligada ao Controlador do Endoscópio, a aba Display na tela de toque do Carrinho de Visão aparece e os botões da câmera acendem. A aba Display é mostrada quando qualquer botão da câmera é acionado. A tela de toque mostra os seguintes controles na aba Display:

Figura 6 Controles da câmera na tela de toque (exemplo)

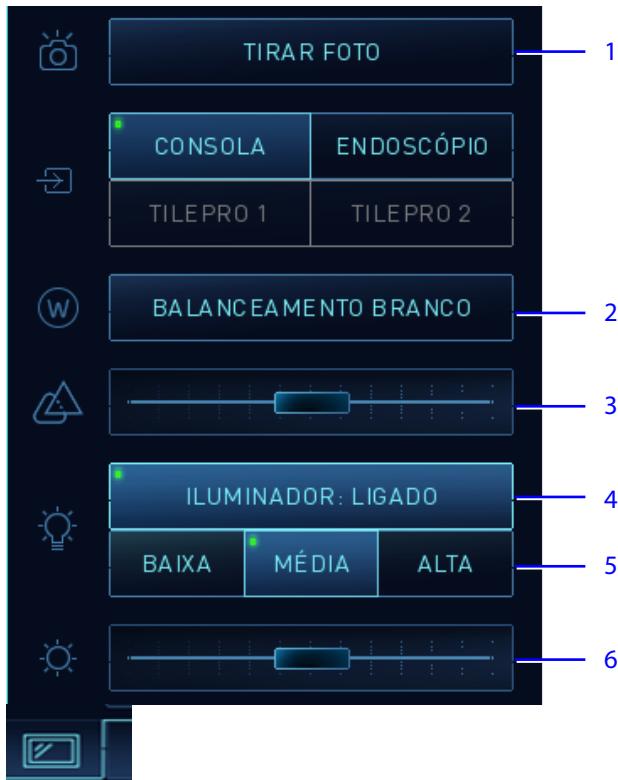

- Botão Tirar Foto:** captura uma imagem a partir da visão laparoscópica. O sistema salva a imagem em uma unidade USB conectada ao processador de vídeo no Carrinho de Visão. Se uma unidade USB não for conectada ao processador de vídeo, o botão Tirar Foto será desabilitado. Se o botão Tirar Foto na Câmera Portátil da Vinci for acionado, o botão Tirar Foto na tela de toque piscará e retornará ao seu estado desativado.
- Botão Balanceamento de Branco:** realiza um ajuste manual do balanço de branco para a Câmera Portátil da Vinci.
- Controle de nitidez na tela de toque:** o controle de nitidez pode precisar ser ajustado, uma vez que a nitidez dos laparoscópios varia conforme o tamanho, o fabricante e o número de vezes que foi utilizado.

4. **Botão Iluminador Ligado/Desligado:** liga ou desliga o Iluminador.
5. **Botões Baixa, Média e Alta para nível de iluminação:** altera o nível de saída do Iluminador. A luminosidade Baixa é 33%, Média é 66% e Alta é 100%. O nível padrão é Alta. Para evitar superaquecimento, selecione o nível mais baixo de iluminação que seja suficiente para uma visualização adequada da área cirúrgica.
6. **Controle de luminosidade na tela de toque:** altera o nível de luminosidade na tela de toque e na tela de visualização do cirurgião. O controle de luminosidade pode precisar ser ajustado para iluminar adequadamente a área cirúrgica, dependendo do tamanho do laparoscópio utilizado no procedimento. Os laparoscópios variam de tamanho conforme o fabricante, fornecendo diferentes quantidades de luz para a área cirúrgica.

As mensagens da câmera são exibidas no módulo de status do braço da câmera.

Figura 7 Exibição do Xi (exemplo)

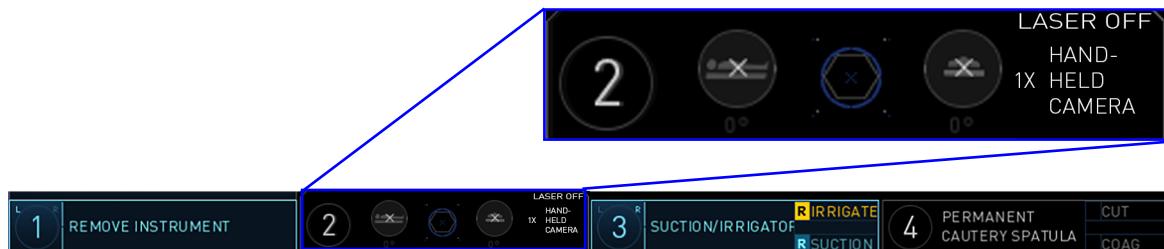


Figura 8 Exibição do SP (exemplo)



Balanço de branco

A Câmera Portátil da Vinci deve ter seu balanço de branco ajustado nas seguintes situações:


- No início de cada procedimento.
- Quando o laparoscópio de terceiros, a Câmera Portátil da Vinci ou o Controlador do Endoscópio for substituído.

O balanço de branco estabelece uma referência cromática branca para o sistema de visão.

Tirar foto

Para tirar uma foto da imagem laparoscópica, aperte o botão **Tirar Foto** da Câmera Portátil da Vinci ou toque no botão **Tirar Foto** na tela do Carrinho de Visão.

Figura 9 Botão Tirar Foto na tela Display (exemplo)



Para salvar a imagem laparoscópica, conecte uma unidade USB ao processador de vídeo no Carrinho de Visão. A imagem poderá então ser recuperada da unidade USB.

Inspeção da Câmera Portátil da Vinci




AVISO: Mantenha um cabeçote de câmera, guias de luz e outros componentes necessários para uso de reserva, para evitar possíveis lesões nos tecidos ou atrasos no procedimento.

Realize uma inspeção visual antes de cada procedimento.


1. Verifique se as superfícies de vidro do cabeçote da Câmera Portátil e do guia de luz estão completamente limpas.
Nota: Não risque as superfícies de vidro do cabeçote da Câmera Portátil ou do guia de luz. Não use escovas: use um pano macio e sem fiapos.
2. Certifique-se de que o conector do cabo da câmera esteja seco e sem avarias.
 - a. Verifique se os contatos no conector do cabo da câmera estão livres de umidade e sujeira.
 - b. Não use a Câmera Portátil da Vinci se houver umidade no conector ou se os contatos estiverem sujos.
3. Com o Iluminador ligado e o guia de luz ligado a ele, aponte a Câmera Portátil da Vinci para uma superfície branca e limpa. Se o vidro da câmera estiver sujo, quaisquer manchas ou sombras que não possam ser vistas na superfície surgirão na tela.
 - a. Limpe as superfícies de vidro sujas com álcool a 70%.
4. Confirme se os anéis de foco e zoom se movem livremente.
 - a. Cada anel deve girar sem agarrar. Os anéis devem responder à força de rotação com uma resistência leve e uniforme.
 - b. Não use a Câmera Portátil da Vinci se os anéis de foco e zoom agarrarem quando forem girados ou estiverem muito soltos.
5. Verifique se há danos no cabo da câmera.
 - a. Certifique-se de que o cabo da câmera esteja intacto.
 - b. Não use a Câmera Portátil da Vinci se o cabo estiver dobrado, quebrado ou torcido.
6. Verifique se há danos na carcaça da câmera.
 - a. Observe se a carcaça apresenta danos externos.
 - b. Não use o dispositivo se a carcaça externa apresentar qualquer dano.
 - c. Certifique-se de que o visor da câmera esteja limpo. Limpe as superfícies de vidro sujas com álcool etílico a 70%.

Inspeção do Guia de Luz


Antes de usar o guia de luz, inspecione o revestimento isolante do cabo e as duas extremidades do guia de luz.

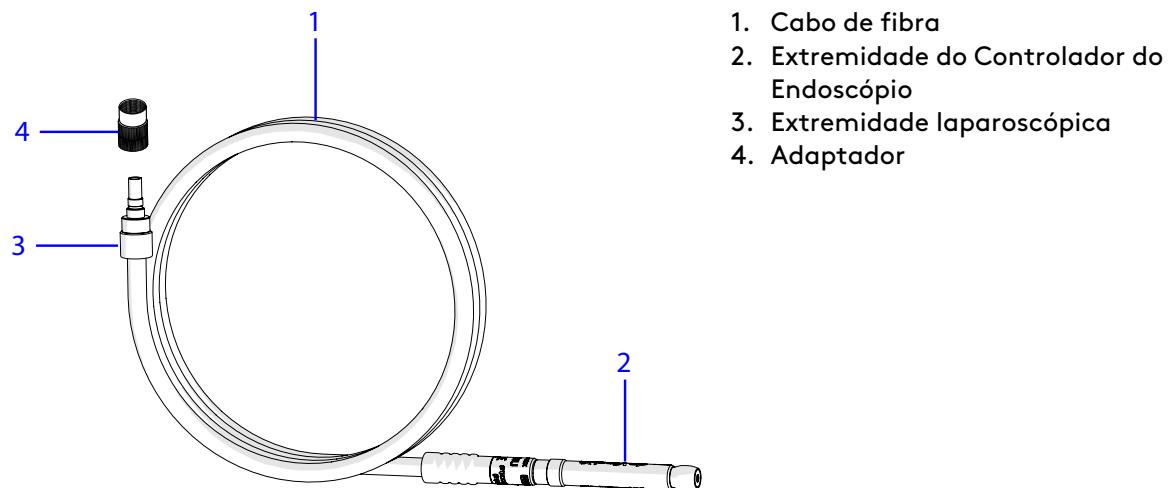

1. Inspecione o revestimento isolante do cabo quanto a cortes, fissuras ou avarias.

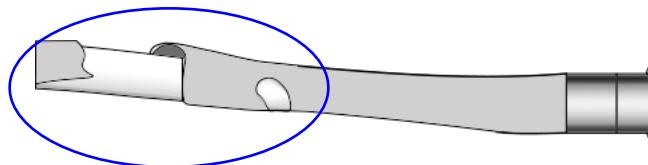


2. Inspecione a ponta na extremidade laparoscópica do guia de luz.

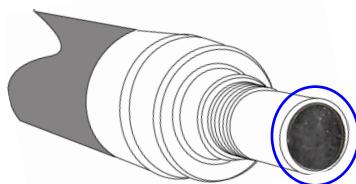

- a. Verifique se a ponta está livre de resíduos.
- b. Verifique se há alguma avaria na ponta.
- c. Verifique se não há peças soltas.


3. Inspecione a extremidade do Controlador do Endoscópio do guia de luz.

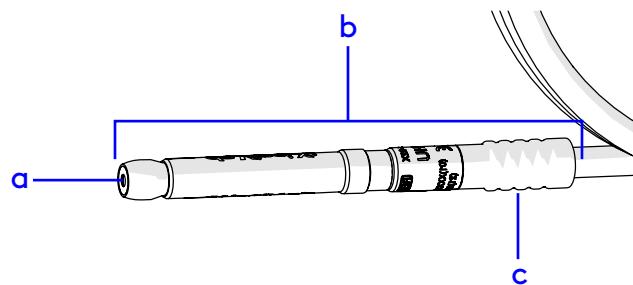

- a. Verifique se o visor da ponta não apresenta arranhões, fissuras ou resíduos.
- b. Verifique se não há peças soltas.
- c. Verifique se o plástico não apresenta fissuras.

4. Inspecione o adaptador.

- a. Verifique se o adaptador está livre de resíduos.
- b. Verifique se consegue girar a extremidade livre do adaptador.



1. Extremidade livre do adaptador

Montagem da Câmera Portátil da Vinci

Montagem e conexão da câmera

AVISO: Use a montagem adequada do dispositivo laparoscópico (por exemplo, cabeçote da câmera, guia de luz e laparoscópio) para evitar danos ao paciente.

AVISO: Conecte o guia de luz e o cabo da câmera antes de inserir o conector da câmera montado no Controlador do Endoscópio para evitar danos ao paciente.

AVISO: Siga as instruções do fabricante para instalação e uso de capas para cabeçotes de câmera fabricadas por terceiros para prevenir infecções.

1. Se desejar, coloque uma capa estéril sobre a Câmera Portátil da Vinci.
2. Gire o anel prateado para alinhar a marca de referência com o ícone do cadeado aberto (destravamento).



3. Pressione as duas alavancas de liberação ao mesmo tempo para retrair os cliques retentores da lente ocular do laparoscópio.




4. Encaixe a lente ocular do laparoscópio nos cliques retentores e libere as alavancas.
5. Gire o anel prateado para alinhar a marca de referência com o ícone do cadeado fechado (travamento).




6. Rosqueie o adaptador do guia de luz no poste do laparoscópio até que esteja firmemente conectado.


7. Deslize o guia de luz para dentro de seu respectivo conector no cabo da câmera. O guia de luz deve fazer um clique sonoro ao se encaixar.

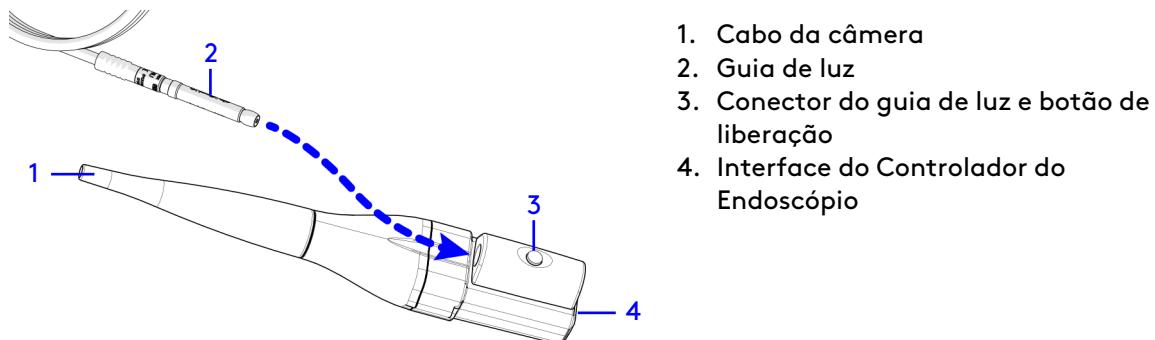

Conector da câmera montado

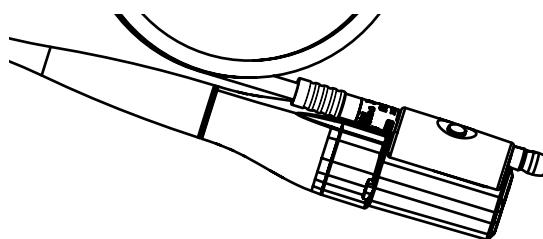

8. Ligue o conector da câmera montado ao Controlador do Endoscópio no Carrinho de Visão.

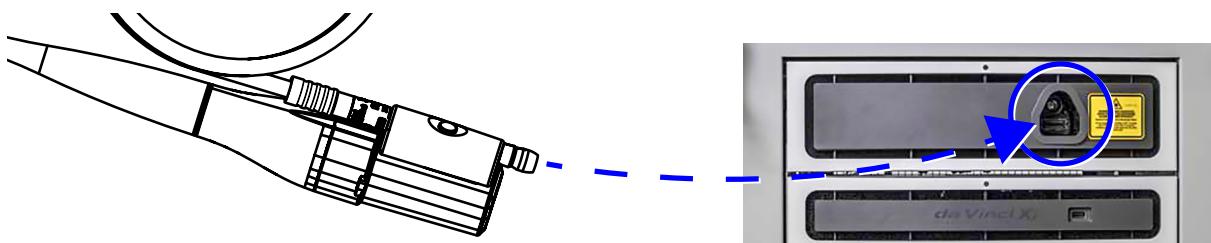


Nota: O LED do Controlador do Endoscópio acende quando a Câmera Portátil da Vinci é conectada.





Nota: No sistema SP, o seguinte indicador (Figura 10) aparece no visor da unidade do endoscópio quando uma Câmera Portátil da Vinci é conectada ao Controlador do Endoscópio e um endoscópio SP é instalado na unidade do endoscópio.

Figura 10 Indicador de câmera portátil



Ativação do Iluminador

- O Iluminador pode ser ligado por meio da Câmera Portátil da Vinci ou da aba Display do Carrinho de Visão. Quando o Iluminador é ligado pela primeira vez, ele é ajustado para a saída máxima. Se o nível de luminosidade for alterado durante um procedimento e o Iluminador for desligado, esse nível será memorizado para o restante do procedimento.

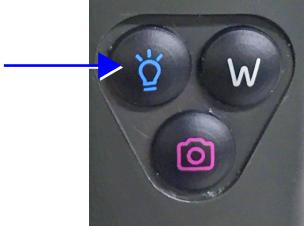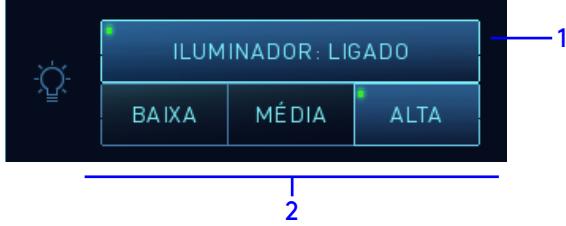Câmera Portátil da Vinci	Carrinho de Visão
<p>a. Pressione longamente o botão Iluminador/Luminosidade na câmera para ligar o Iluminador.</p>  <p>b. Pressione brevemente o botão Iluminador/Luminosidade na câmera para alternar entre os sete níveis de luminosidade, do menor para o maior.</p>	<p>a. Toque no botão Iluminador Ligado/Desligado na aba Display do Carrinho de Visão.</p> <p>b. Toque no botão Baixa, Média ou Alta para mudar o nível de luminosidade do Iluminador.</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Botão Iluminador Ligado/Desligado na aba Display 2. Botões Baixa, Média e Alta para nível de iluminação

Configuração do balanço de branco

- Ligue o Iluminador.
- Dirione a ponta do laparoscópio para um objeto branco, de tal modo que o objeto cubra todo o campo de visão. O objeto branco deve estar a aproximadamente 10 cm (4 pol.) da ponta do laparoscópio.
- Ajuste o balanço de branco da Câmera Portátil da Vinci usando o botão na câmera ou na aba Display do Carrinho de Visão.


Câmera Portátil da Vinci	Carrinho de Visão
Pressione longamente o botão Balanço de Branco na câmera.	Toque no botão Balanço de Branco na aba Display.





Uma mensagem indicando se o balanço de branco foi realizado com sucesso surgirá na tela.

Ajustar foco e zoom

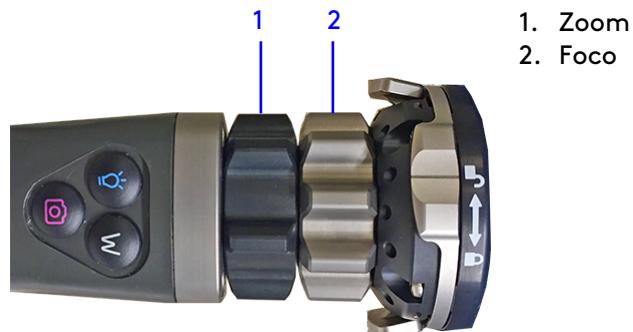

Para ajustar os níveis de foco e zoom, gire os anéis de zoom e foco da câmera.

1. Ajuste o tamanho de imagem desejado utilizando o anel de zoom.
2. Aponte a Câmera Portátil da Vinci para uma estrutura com contornos bem definidos, à distância de trabalho desejada.
3. Ajuste o anel de foco da Câmera Portátil da Vinci até que a imagem fique nítida.


Desconexão da Câmera Portátil da Vinci

- O Iluminador pode ser desligado por meio da Câmera Portátil da Vinci ou da aba Display do Carrinho de Visão.



Nota: Quando o Iluminador estiver desligado, o botão muda para Iluminador: Desligado.

Câmera Portátil da Vinci	Carrinho de Visão
Pressione longamente o botão Iluminador na câmera para desligar o Iluminador.	Toque no botão Iluminador Ligado/Desligado na aba Display do Carrinho de Visão.

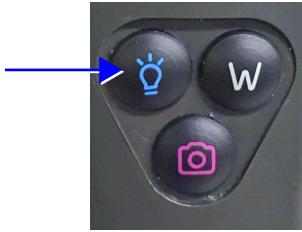

→



1
2

- Botão Iluminador Ligado/Desligado na aba Display
- Botões Baixa, Média e Alta para nível de iluminação

- Gire o anel prateado para alinhar a marca de referência com o ícone do cadeado aberto (destravamento).




- Pressione as alavancas de liberação para desconectar o laparoscópio da Câmera Portátil da Vinci.




- Desenrosque do laparoscópio o adaptador do guia de luz.
- Se uma capa estéril tiver sido colocada sobre a Câmera Portátil da Vinci, remova e descarte a capa usada de acordo com as instruções do fabricante.

6. Retire o conector da câmera montado do Controlador do Endoscópio.

AVISO: Não puxe somente pelo guia de luz ou pelo cabo da câmera ao desconectar o conector da câmera montado do Controlador do Endoscópio, para evitar danos ao cabo de fibra ou ao conector do guia de luz. Danos podem levar a infecções.

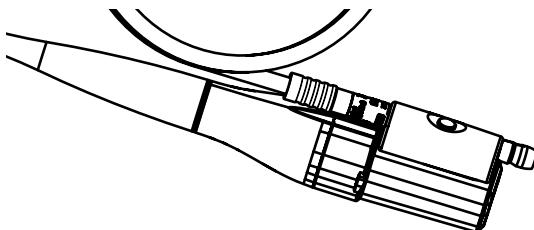

7. Pressione o botão de liberação do guia de luz para removê-lo de seu respectivo conector.

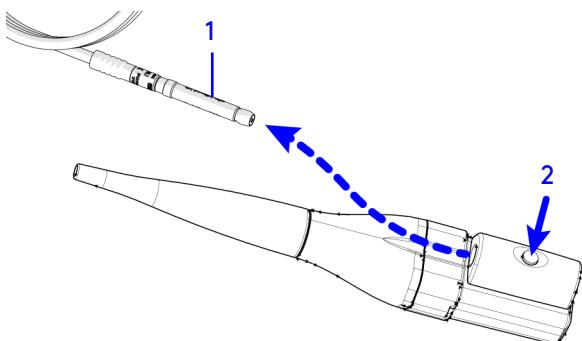

1. Guia de luz
2. Botão de liberação do guia de luz

8. Remova o adaptador do guia de luz.

9. Use um pano úmido e sem fiapos para remover o máximo possível qualquer resíduo visível.

10. Realize o procedimento de reprocessamento. Consulte as *Instruções de Reprocessamento da Câmera Portátil da Vinci*.

11. Inspecione o obturador ótico depois do uso. Certifique-se de que a ponta não esteja danificada.

Armazenamento, transporte e embalagem

Descuidos durante o manuseio do dispositivo podem danificá-lo, resultando em riscos para o paciente. Manuseie o dispositivo com o devido cuidado. Não torça, amasse ou dobre acentuadamente o cabo da câmera. Se o dispositivo sofrer uma queda ou elevada tensão mecânica, interrompa seu uso e entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

i **Nota:** O manuseio, manutenção e uso indevidos trazem riscos ao paciente, ao usuário e a outras pessoas ou podem causar um desgaste prematuro do dispositivo.

i **Nota:** Não tente realizar nenhum reparo ou manutenção no dispositivo ou em seus componentes. Todo reparo ou manutenção deve ser realizado em uma assistência técnica autorizada.

Armazenamento e transporte

Condições de transporte e armazenamento:

Temperatura	-20 a 70 °C
Umidade relativa do ar	5 a 95%
Pressão atmosférica	50 a 106 kPa

Guarde o dispositivo em ambiente seco, bem ventilado, com temperatura controlada e ao abrigo da poeira.

Ao guardar o dispositivo, verifique se não há outros objetos ou estruturas ao seu redor que possam danificá-lo.

Para evitar avarias, mantenha o dispositivo longe de luz solar direta, radioatividade e campos eletromagnéticos fortes.

Resolução de problemas

Alimentação do Carrinho de Visão

Para problemas com a alimentação do Carrinho de Visão, consulte o respectivo manual do usuário do sistema.

Potência de iluminação

A potência de iluminação dos laparoscópios de outros fabricantes varia conforme o diâmetro e as condições do laparoscópio conectado. Em geral, o nível de iluminação influencia diretamente a temperatura dos componentes. Portanto, a potência de iluminação pode precisar ser ajustada por meio dos botões de **Nível de Iluminação** na aba "Display" do Carrinho de Visão.

Qualidade de imagem

Problema	Possível causa	Ação
A imagem está muito escura; pouca iluminação	As superfícies de vidro da Câmera Portátil da Vinci estão sujas.	Limpe as superfícies de vidro.
	As superfícies de vidro no guia de luz apresentam resíduos.	Remova os resíduos de acordo com as <i>Instruções de Reprocessamento da Câmera Portátil da Vinci</i> . Verifique a qualidade da água.
	O guia de luz não está conectado corretamente.	Verifique a conexão do guia de luz com o laparoscópio de terceiros.
	O guia de luz está com defeito.	Conecte um novo guia de luz.
	A luminosidade da câmera está muito baixa.	Aumente a luminosidade da câmera.
	O sistema ótico da câmera está com defeito.	Se a imagem estiver muito escura ou invisível, utilize outro laparoscópio. Utilize outra Câmera Portátil da Vinci.
	A configuração de saída de luz está muito baixa.	Selecione um nível de iluminação maior (Média ou Alta) para aumentar a saída de luz da fonte iluminadora.
A imagem não está nítida	O laparoscópio pode estar embaçado ou com detritos.	Siga as instruções do fabricante do laparoscópio para limpar a imagem. Ajuste os anéis de foco e zoom. Substitua o laparoscópio.

Problema	Possível causa	Ação
A imagem está com qualidade ruim	O nível selecionado de saída do Iluminador está muito baixo.	Selecione um nível de iluminação maior (Média ou Alta) para aumentar a saída de luz da fonte iluminadora. Ajuste o controle de nitidez. Substitua o laparoscópio.
Imagen de “túnel”	O zoom está muito afastado.	Ajuste o anel de zoom para aproximar a imagem.
Não há imagem no monitor	Não há iluminação.	Conecte o cabo da câmera ao Controlador do Endoscópio.
	A Câmera Portátil da Vinci não está conectada ao Controlador do Endoscópio ou está com defeito.	Conecte a Câmera Portátil da Vinci ao Controlador do Endoscópio. Verifique se há umidade no conector do cabo. Substitua a Câmera Portátil da Vinci.
A fonte de luz liga e desliga sozinha	A Câmera Portátil da Vinci está com defeito.	Substitua a Câmera Portátil da Vinci.

Látex de borracha natural

Para os seguintes produtos cirúrgicos elastoméricos/maleáveis da Intuitive™ mencionados neste manual, os materiais destinados ao contato com usuários ou pacientes durante o uso e manuseio normais não são fabricados com látex de borracha natural:

- Da Vinci Handheld Camera (Câmera Portátil da Vinci) (PN 470035)
- Handheld Camera Light Guide (Guia de Luz da Câmera Portátil) (PN 470042)

Fim
